



เอกสารประกอบ

การตรวจสอบพัสดุประจำปี ในระบบสินทรัพย์ (AM)


โดย

งานพัสดุ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

วิธีการเรียก “รายงานการตรวจนับสินทรัพย์” และวิธีการเรียก “ข้อมูลหลักสินทรัพย์รายตัว”


วิธีการเรียก “รายงานการตรวจนับสินทรัพย์”

เรียกรายงานด้วยคำสั่ง T-code : ZAMRP005

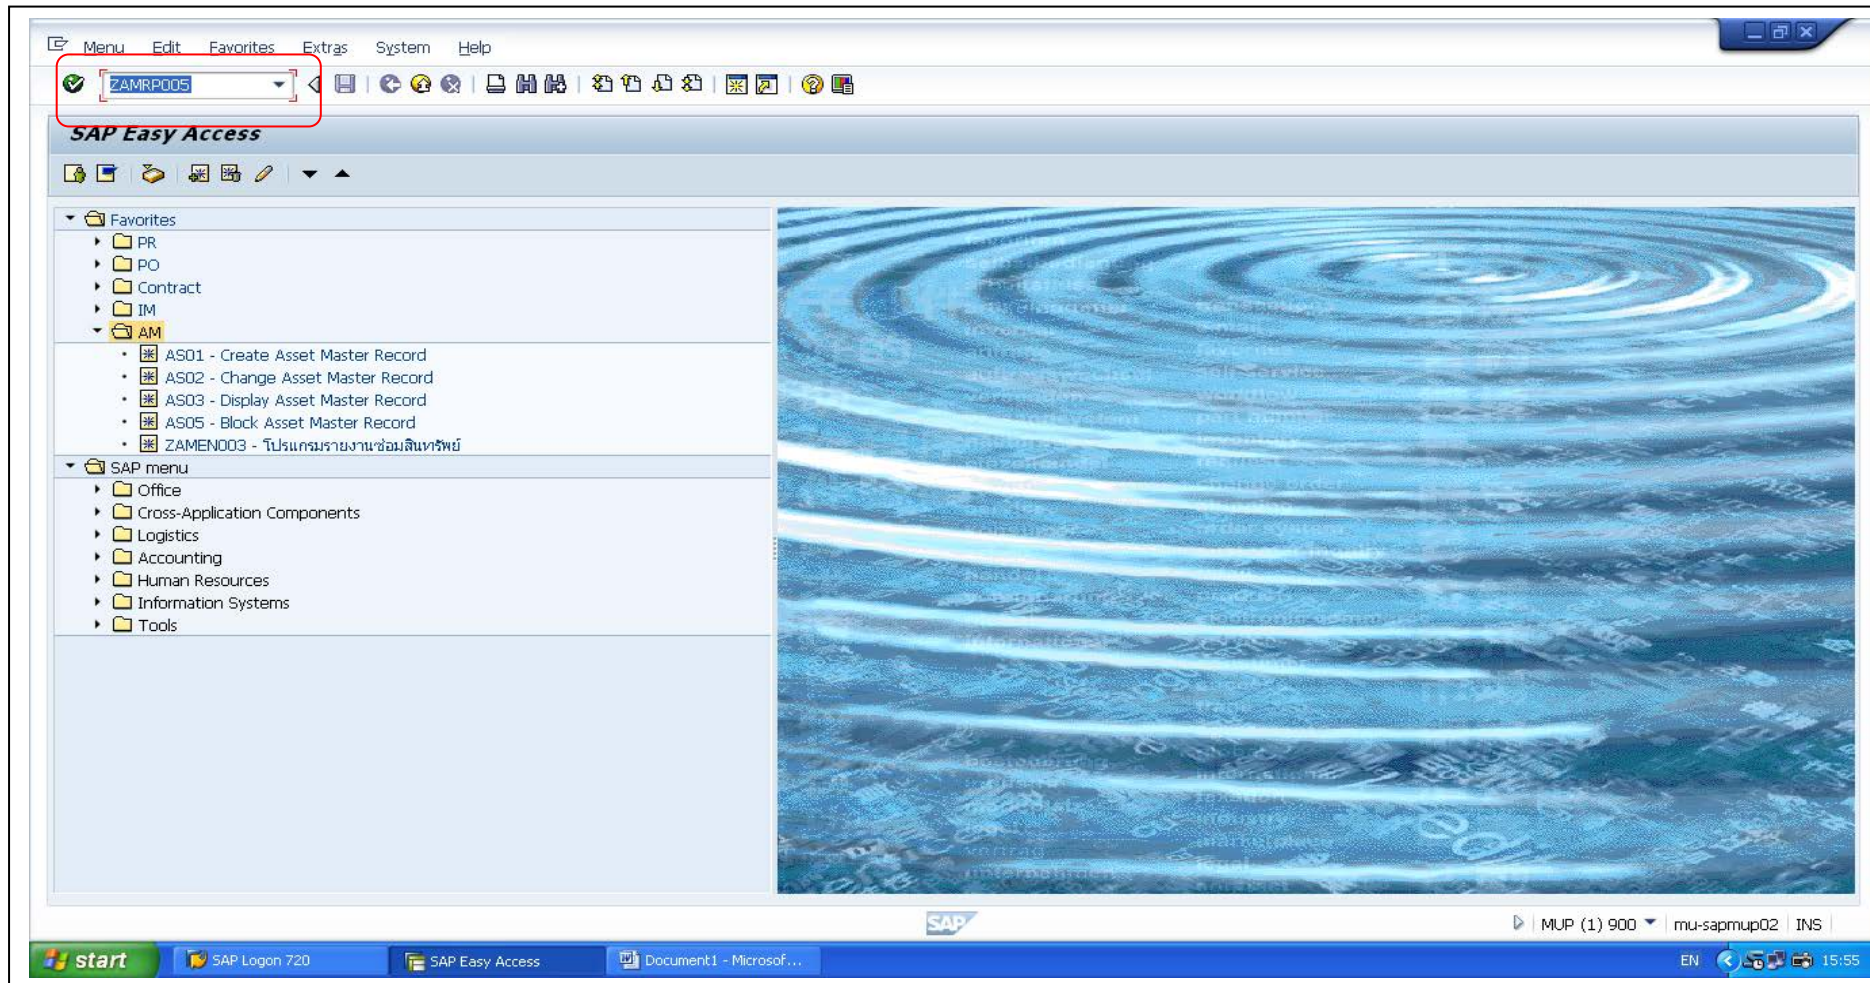

ก่อนทำการค้นหารายงานสินทรัพย์ของหน่วยงานของตนเอง


1. ให้กดปุ่ม Variant name (หมายเลข 1) จะได้น้ำจอร์รายละเอียด description Variant name ให้เลือกรายงาน ตรวจสอบสินทรัพย์ (หมายเลข 2) ระบบจะทำการคัดกรอง ข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ โดยจะไม่นำข้อมูลที่ได้มีการจำหน่ายหรือยกเลิกการใช้งานไปแล้วมาแสดงผล แล้วกดปุ่มตกลงเพื่อให้ระบบทำงาน (หมายเลข 3)

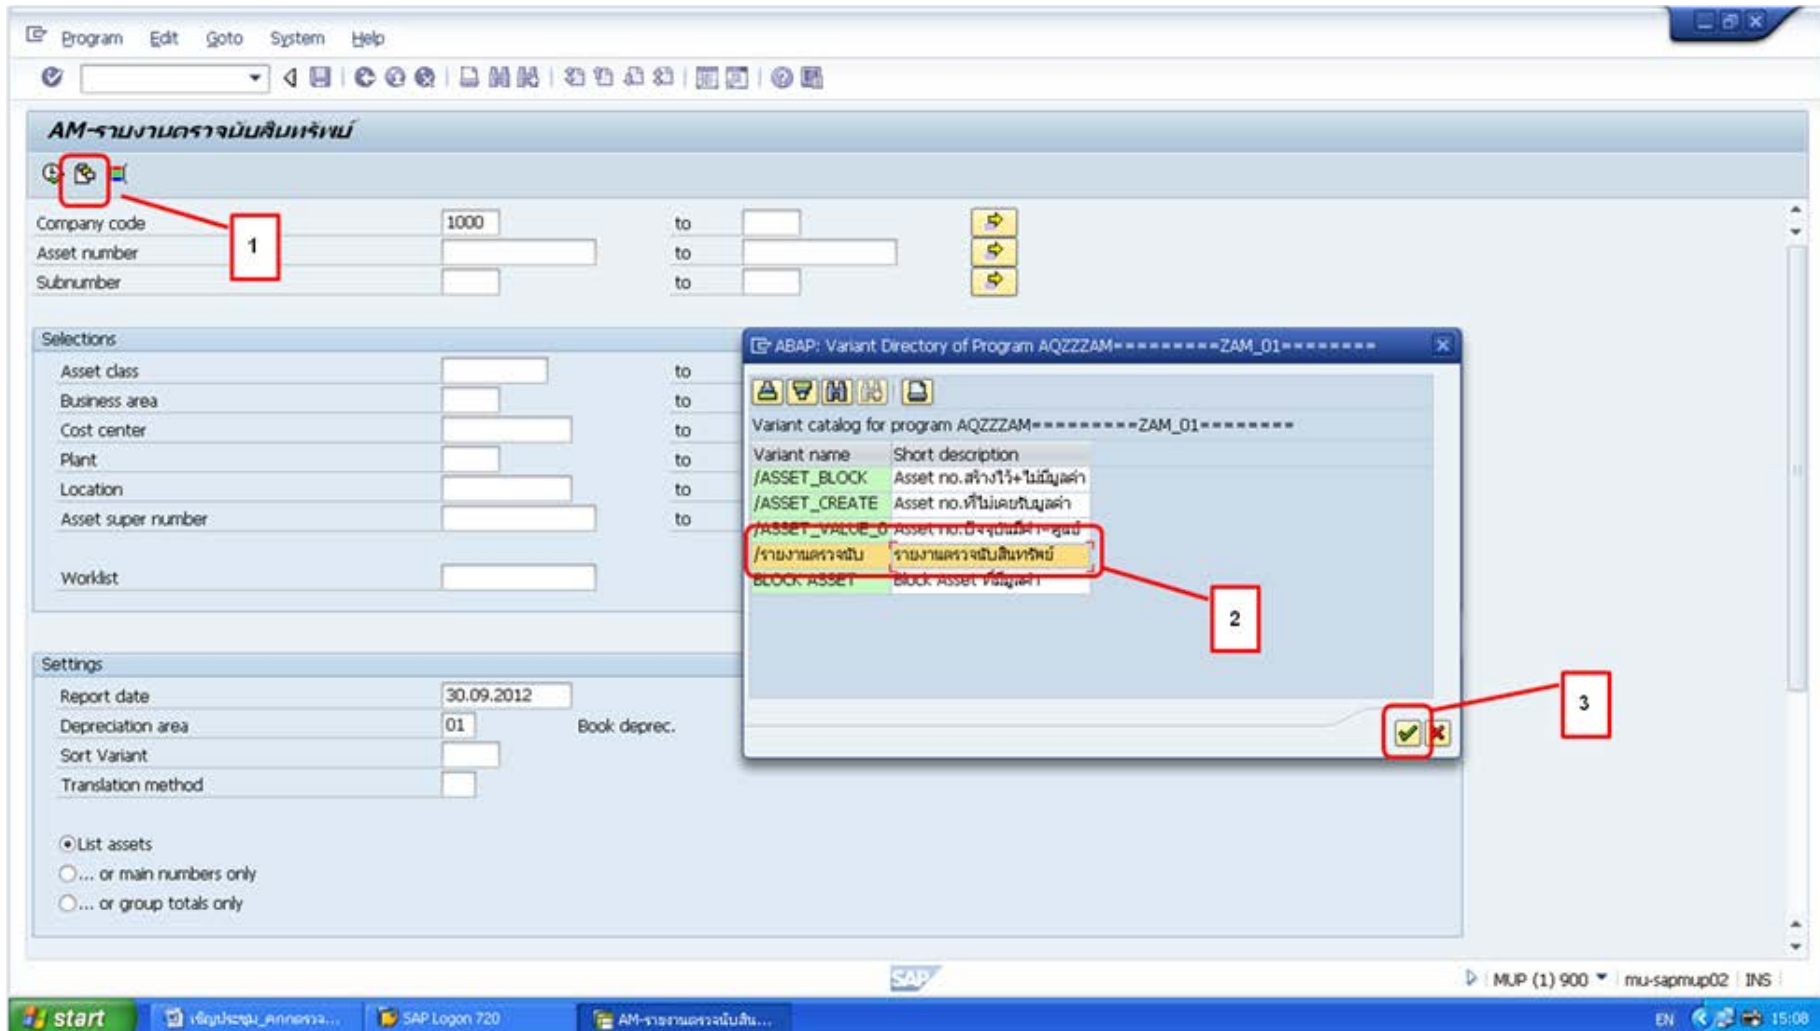


2. ทำการค้นหารายงานสินทรัพย์ของหน่วยงานตนเอง ใน Field : Cost center โดยใส่ รหัส Cost center (EX. ภาควิชาภูมิารเวชศาสตร์เขตร้อน C1108000)

The screenshot shows the SAP AM-รายงานครุภัณฑ์สินทรัพย์ (AM-Asset Report) interface. The 'Cost center' field in the 'Selections' section is highlighted with a red box. The 'Asset class' is set to 80100 and 'to' is 80500. The 'Report date' is 30.09.2013. The 'Deactivation date' is 01.01.1999. The 'Output format' is set to 'SAP List Viewer' with the Thai text '/ตรวจใบ'.

Field	Value	to	Value
Company code	1000		
Asset number			
Subnumber			
Asset class	80100		80500
Business area			
Cost center			
Plant			
Location			
Asset super number			
Worklist			
Report date	30.09.2013		
Depreciation area	01	Book deprec.	
Sort Variant	Z003	Fund / Cost center/Description 2	
Translation method			
Asset capitalization date			
Deactivation date	01.01.1999		30.09.2013
Cost Center			
Room			
Asset location			

3. เมื่อใส่ Cost center แล้ว ให้กดปุ่ม Execute รูป  ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

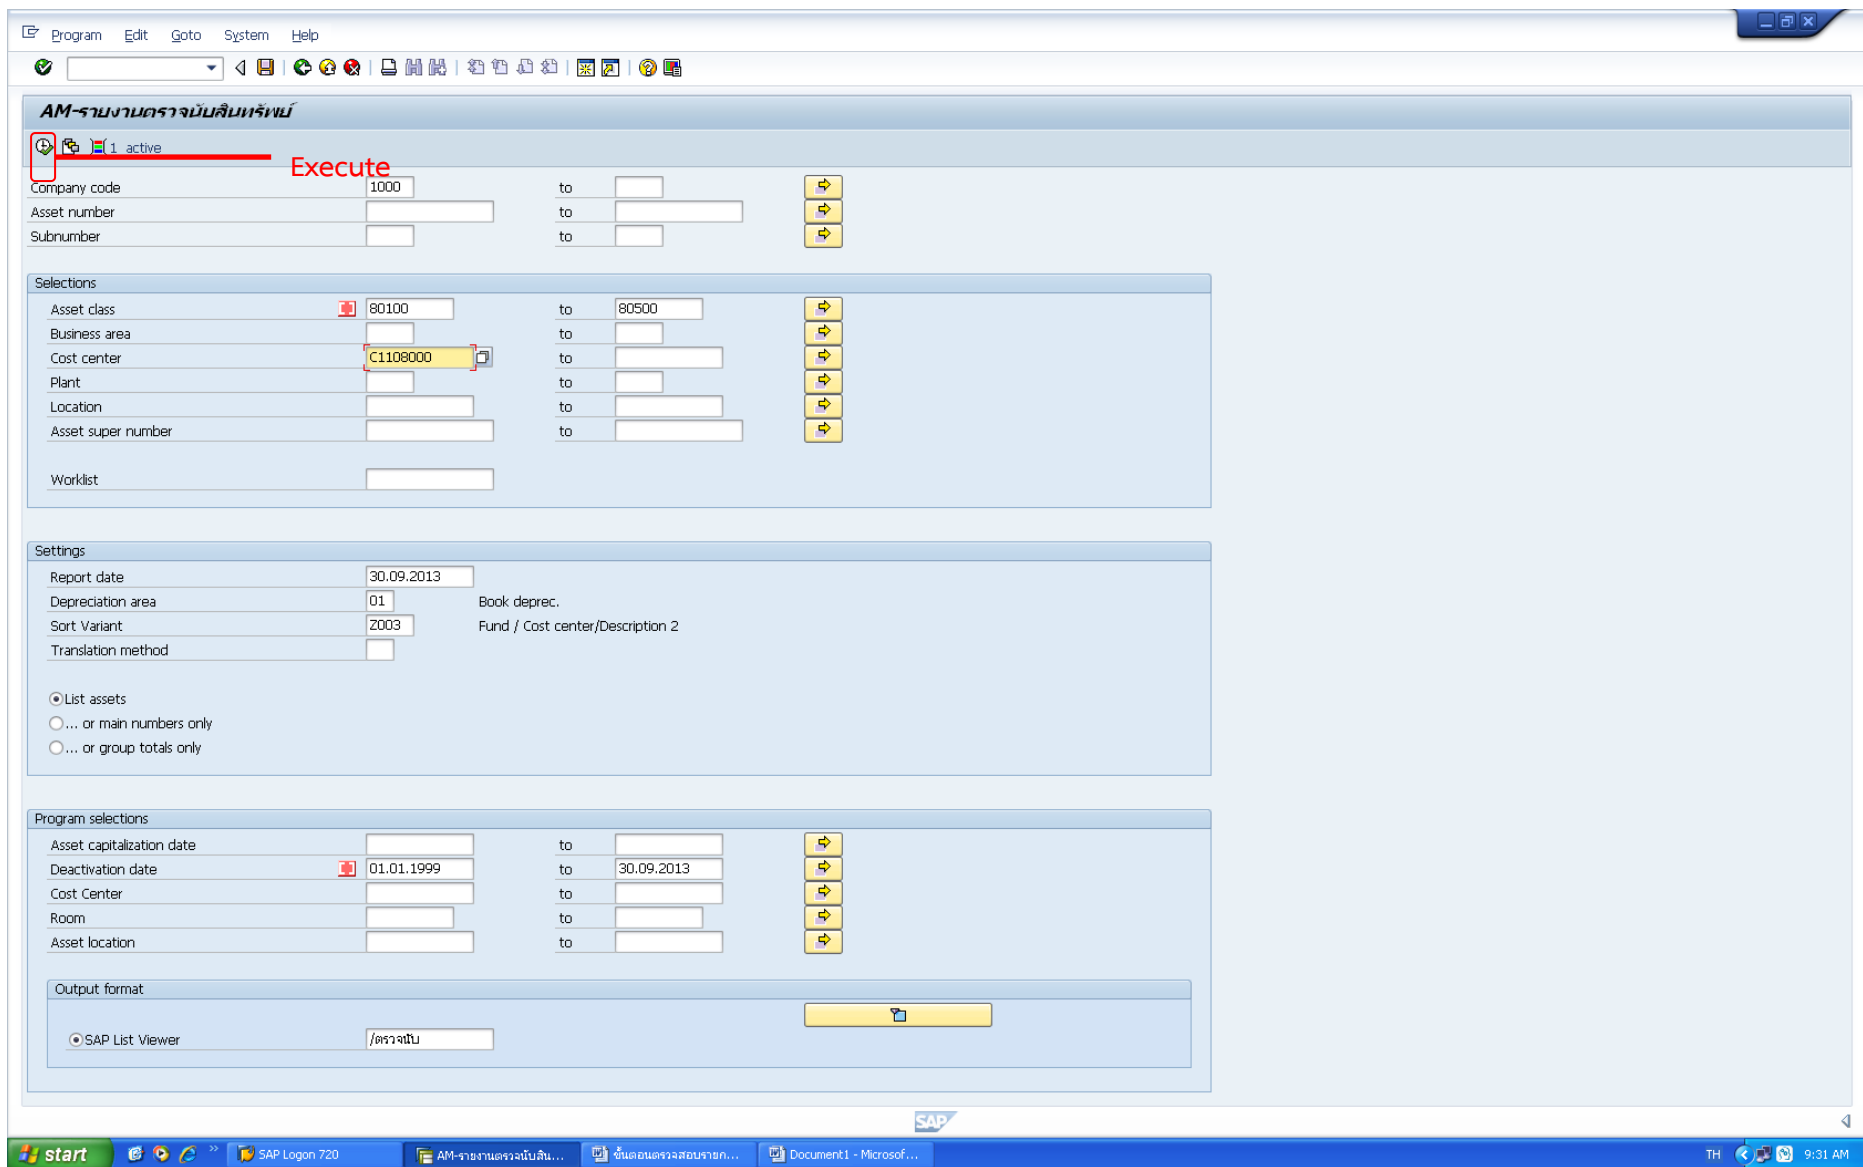

AM-รายงานการนับสินทรัพย์

1 active **Execute**

Company code 1000 to [] [Execute]

Asset number [] to [] [Execute]

Subnumber [] to [] [Execute]

Selections

Asset class 80100 to 80500 [Execute]

Business area [] to [] [Execute]

Cost center C1108000 to [] [Execute]

Plant [] to [] [Execute]

Location [] to [] [Execute]

Asset super number [] to [] [Execute]

Worklist []

Settings

Report date 30.09.2013

Depreciation area 01 Book deprec.

Sort Variant 2003 Fund / Cost center/Description 2

Translation method []

List assets

... or main numbers only

... or group totals only

Program selections

Asset capitalization date [] to [] [Execute]

Deactivation date 01.01.1999 to 30.09.2013 [Execute]

Cost Center [] to [] [Execute]

Room [] to [] [Execute]


Asset location [] to [] [Execute]

Output format

SAP List Viewer /ตรวจนับ [Execute]

SAP

start SAP Logon 720 AM-รายงานการนับสินทรัพย์... SAP Logon 720 Document1 - Microsof... TH 9:31 AM

4. เมื่อกดปุ่ม Execute รูป  ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏข้อมูลรายงานตรวจนับสินทรัพย์ของหน่วยงานดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

AM-รายงานตรวจนับสินทรัพย์

AM-รายงานตรวจนับสินทรัพย์

Cost Ctr	Inventory number	Asset	SNo.	Asset description 1	Asset description 2	Fund	Curr.acq.value	Asset location	Room	สภาพของสินทรัพย์	Deact.Dat
C1108000	TM.O-53-004	401000013147	0	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด 7 รายการ		10101001	60,000.00	ตึกศูนย์วิจัยทางคลินิกโรคเขตร้อน		ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1156018-401000032905-0	401000032905	0	โต๊ะวางเครื่องปั่นเลือด ขนาด 100x80x75 ซม	รับน้ำหนักได้ 200 กก.	10101001	9,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM.D-45-024	402000000124	0	รถยนต์ ยี่ห้อ ฮีซุซ รุ่น ทริปเปอร์ เอส.อี.แอล.		10101001	818,500.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM.O-52-054-1/1	402000000138	0	รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 16 ที่นั่ง	เลขตัวรถ JTFRX13P608014995 (กรุงเทพฯ)	10101001	1,060,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM.O-52-055-1/1	402000000139	0	รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VENTURY 1.7V เลขเครื่อง	เลขตัวรถ JTFSS22P5000060176 (กรุงเทพฯ)	10101001	1,420,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM.O-52-137-1/1	402000000389	0	รถยนต์ Camry Hybrid		10101001	618,518.30			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM.D-45-014	404000002364	0	เครื่องฉายทอดสัญญาณภาพวิดีโอสามมิติ		10101001	104,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM.O-52-042-1/1	404000002428	0	เครื่องฉายภาพ LCD Projector ยี่ห้อ Panasonic	FT-LB51EA	10101001	35,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM.O-54-040	409000005589	0	เครื่องปั่นเหวี่ยงเลือด LAB CENTRIFUGE MPW-223e		10101001	110,000.00	ตึกเฉลิมพระเกียรติ		ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM-50-003-1/2	409000005754	0	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส	พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U53V	20101002	555,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM-50-003-2/2	409000005755	0	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส	พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U53V	20101002	555,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM-50-006	409000005758	0	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air flow) พร้อมอุปกรณ์	ยี่ห้อ Esco รุ่น LA2-4AX	20101002	451,540.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM-50-011	409000005764	0	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	ผลิตภัณฑ์ของ MPW รุ่น 350R	20101002	272,850.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM-50-015-1/2	409000005767	0	กล่องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมอุปกรณ์	ยี่ห้อ Motic รุ่น AE31	20101002	249,500.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	TM-50-015-2/2	409000005768	0	กล่องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมอุปกรณ์	ยี่ห้อ Motic รุ่น AE31	20101002	249,500.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1156019-409000009503-0	409000009503	0	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา รุ่น CX31		10101001	85,000.00		ชั้น 6	ใช้งานอยู่	00.00.00
C1109000	1155079-409000010661-0	409000010661	0	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ และควบคุมอุณหภูมิ	รุ่น Centrifuge 5810R	20101004	467,000.00	ตึกศูนย์วิจัยทางคลินิกโรคเขตร้อน	ชั้น 6	ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012545-0	409000012545	0	Horizontal SUB6 ขนาด 6x7cm (17,000บ.)	(DPL)55 1075511082	10101001	16,087.12			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012814-0	409000012814	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012815-0	409000012815	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012816-0	409000012816	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012817-0	409000012817	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012818-0	409000012818	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012819-0	409000012819	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012820-0	409000012820	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012821-0	409000012821	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012822-0	409000012822	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012823-0	409000012823	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012824-0	409000012824	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012825-0	409000012825	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012826-0	409000012826	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012827-0	409000012827	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012828-0	409000012828	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012829-0	409000012829	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012830-0	409000012830	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012831-0	409000012831	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012832-0	409000012832	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012833-0	409000012833	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012834-0	409000012834	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00
C1108000	1155000-409000012835-0	409000012835	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500บ.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.00

5.ให้ทำการเลือกคอลัมน์ Fund : แหล่งเงิน (หมายเลข 1) และกดปุ่ม



(หมายเลข 2) เพื่อรายงานจะได้รวมมูลค่าสินทรัพย์ตามแหล่งเงินให้

SAP AM-รายงานตรวจนับสินทรัพย์


AM-รายงานตรวจนับสินทรัพย์

Asset	SNo.	Asset description 1	Asset description 2	Fund	Cur.acq.value	Asset location	Room	สภาพของสินทรัพย์	Deact.Date	ปีงาที่ไดมา	Quantity	BUn
401000013147	0	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด 7 รายการ		10101001	60,000.00	ตึกศูนย์วิจัยทางคดีนิติโรคเขตร่อน		ใช้งานอยู่	00.00.0000	2553	1.000	
401000032905	0	โต๊ะวางเครื่องปั้นเคลือบ ขนาด 100x80x75 ซม	รุ่นไม้ท่อนไม้ 200 กก.	10101001	9,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2556	1.000	
402000000124	0	รถยนต์ ยี่ห้อ ฮีซุซ รุ่น ทริปเปอร์ เอส.อี.แอล.		10101001	818,500.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2545	1.000	
402000000138	0	รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 16 ที่นั่ง	เลขตัวรถ JTRFX13P608014995 (กุมารา)	10101001	1,060,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2552	1.000	
402000000139	0	รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VENTURY 2.7V เลขเครื่อง	เลขตัวรถ JTFSS22P5000060176 (กุมารา)	10101001	1,420,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2552	1.000	
402000000389	0	รถยนต์ Camry Hybrid		10101001	618,518.30			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2552	1.000	
404000002364	0	เครื่องถ่ายเอกสารสีคุณภาพดี		10101001	104,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2545	1.000	
404000002428	0	เครื่องฉายภาพ LCD Projector ยี่ห้อ Panasonic	FT-LB51EA	10101001	35,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2552	1.000	
409000005589	0	เครื่องปั่นแห้งยี่ห้อ LAB CENTRIFUGE MPW-223e		10101001	110,000.00	ตึกเฉลิมพระเกียรติ		ใช้งานอยู่	00.00.0000	2554	1.000	
409000005754	0	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส	พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U53V	20101002	555,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2550	1.000	
409000005755	0	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส	พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U53V	20101002	555,000.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2550	1.000	
409000005758	0	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air flow) พร้อมอุปกรณ์	ยี่ห้อ Esco รุ่น LA2-4AX	20101002	451,540.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2550	1.000	
409000005764	0	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	ผลิตภัณฑ์ของ MPW รุ่น 350R	20101002	272,850.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2550	1.000	
409000005767	0	กล้องจุลทรรศน์ชนิดหักเหี้ยว พร้อมอุปกรณ์	ยี่ห้อ Motic รุ่น AE31	20101002	249,500.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2550	1.000	
409000005768	0	กล้องจุลทรรศน์ชนิดหักเหี้ยว พร้อมอุปกรณ์	ยี่ห้อ Motic รุ่น AE31	20101002	249,500.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2550	1.000	
409000009503	0	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา รุ่น CX31		10101001	85,000.00		ชั้น 6	ใช้งานอยู่	00.00.0000	2556	1.000	
409000010661	0	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ และควบคุมอุณหภูมิ	รุ่น Centrifuge 5810R	20101004	467,000.00	ตึกศูนย์วิจัยทางคดีนิติโรคเขตร่อน	ชั้น 6	ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012545	0	Horizontal SUB6 ขนาด 6x7cm (17,000u.)	(DPL)55 I075511082	10101001	16,087.12			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	2.000	
409000012814	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012815	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012816	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012817	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012818	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012819	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012820	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012821	0	Autopipette ขนาด 100 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012822	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012823	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012824	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012825	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012826	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012827	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012828	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012829	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012830	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012831	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012832	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012833	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012834	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	
409000012835	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 I075511080	10101001	0.00			ใช้งานอยู่	00.00.0000	2555	1.000	

ตัวอย่างรายงานรวมมูลค่าสินทรัพย์ตามแหล่งเงิน


Cost Ctr	Inventory number	Asset	SNo.	Asset description 1	Asset description 2	Fund	Curr.acq.value	Asset location	Room	สภาพของสินทรัพย์	Deact.Dat
C1108000	1155000-409000012822-0	409000012822	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080	10101001	0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012823-0	409000012823	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012824-0	409000012824	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012825-0	409000012825	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012826-0	409000012826	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012827-0	409000012827	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012828-0	409000012828	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012829-0	409000012829	0	Autopipette ขนาด 200 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012830-0	409000012830	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012831-0	409000012831	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012832-0	409000012832	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012833-0	409000012833	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012834-0	409000012834	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012835-0	409000012835	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012836-0	409000012836	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155000-409000012837-0	409000012837	0	Autopipette ขนาด 1000 ul (9,500u.)	(DPL)55 1075511080		0.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM.O-48-107	410000007810	0	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PPSST รุ่น Pentium 4-300			42,800.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM.O-49-059	410000007912	0	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PPSST รุ่น AMD 64 3000+			41,088.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM.O-50-123	410000007990	0	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745SMT	Minitower		40,660.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM.O-50-133	410000007992	0	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP	รุ่น LaserJet P2015		15,087.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM.O-51-027	410000008003	0	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP PAVILION A6385L พร้อมจอภาพ			30,174.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1154043-410000016604-0	410000016604	0	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200Pro + จอ HP LE1911			26,543.00				00.00.00
C1108000	1154043-410000016605-0	410000016605	0	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200Pro + จอ HP LE1911			26,543.00				00.00.00
C1108000	1154043-410000016606-0	410000016606	0	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200Pro + จอ HP LE1911			26,543.00				00.00.00
C1108000	1154043-410000016607-0	410000016607	0	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200Pro + จอ HP LE1911			26,543.00				00.00.00
C1108000	1154100-410000016928-0	410000016928	0	Printer Laser ยี่ห้อ Lexmark รุ่น X654de			22,898.00	ตึกโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	ชั้น 6		00.00.00
C1108000	1155262-410000019858-0	410000019858	0	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	ยี่ห้อ Dell(TM) PowerEdge(TM) T110 II Server		85,065.00	ตึกศูนย์วิจัยทางคลินิกโรคเขตร้อน	ชั้น 6	ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	1155010-410000019868-0	410000019868	0	เครื่องสแกนเนอร์	ยี่ห้อ HP รุ่น ScanJet5590		17,141.40	ตึกโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	ชั้น 6		00.00.00
						10101001	= 4,737,190.82				
C1108000	TM-50-003-1/2	409000005754	0	ตู้เย็นเชิงอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส	พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U53V	20101002	555,000.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM-50-003-2/2	409000005755	0	ตู้เย็นเชิงอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส	พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U53V		555,000.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM-50-006	409000005758	0	ตู้ปลอดเชื้อ (Larmarin air flow) พร้อมอุปกรณ์	ยี่ห้อ Esco รุ่น LA2-4AX		451,540.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM-50-011	409000005764	0	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	ผลิตภัณฑ์ของ MPW รุ่น 350R		272,850.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM-50-015-1/2	409000005767	0	กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมอุปกรณ์	ยี่ห้อ Motic รุ่น AE31		249,500.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
C1108000	TM-50-015-2/2	409000005768	0	กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมอุปกรณ์	ยี่ห้อ Motic รุ่น AE31		249,500.00			ใช้งานแล้ว	00.00.00
						20101001	= 2,333,390.00				
C1108000	1155078-409000010661-0	409000010661	0	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ และควบคุมอุณหภูมิ	รุ่น Centrifuge 5810R		467,000.00	ตึกศูนย์วิจัยทางคลินิกโรคเขตร้อน	ชั้น 6		00.00.00
						20101001	= 467,000.00				
							= 7,537,580.82				

การพิมพ์รายงาน โดยการ Export File ในรูป Excel File : ให้กดปุ่ม Local File รูป  และทำการเลือกปุ่ม Spreadsheet

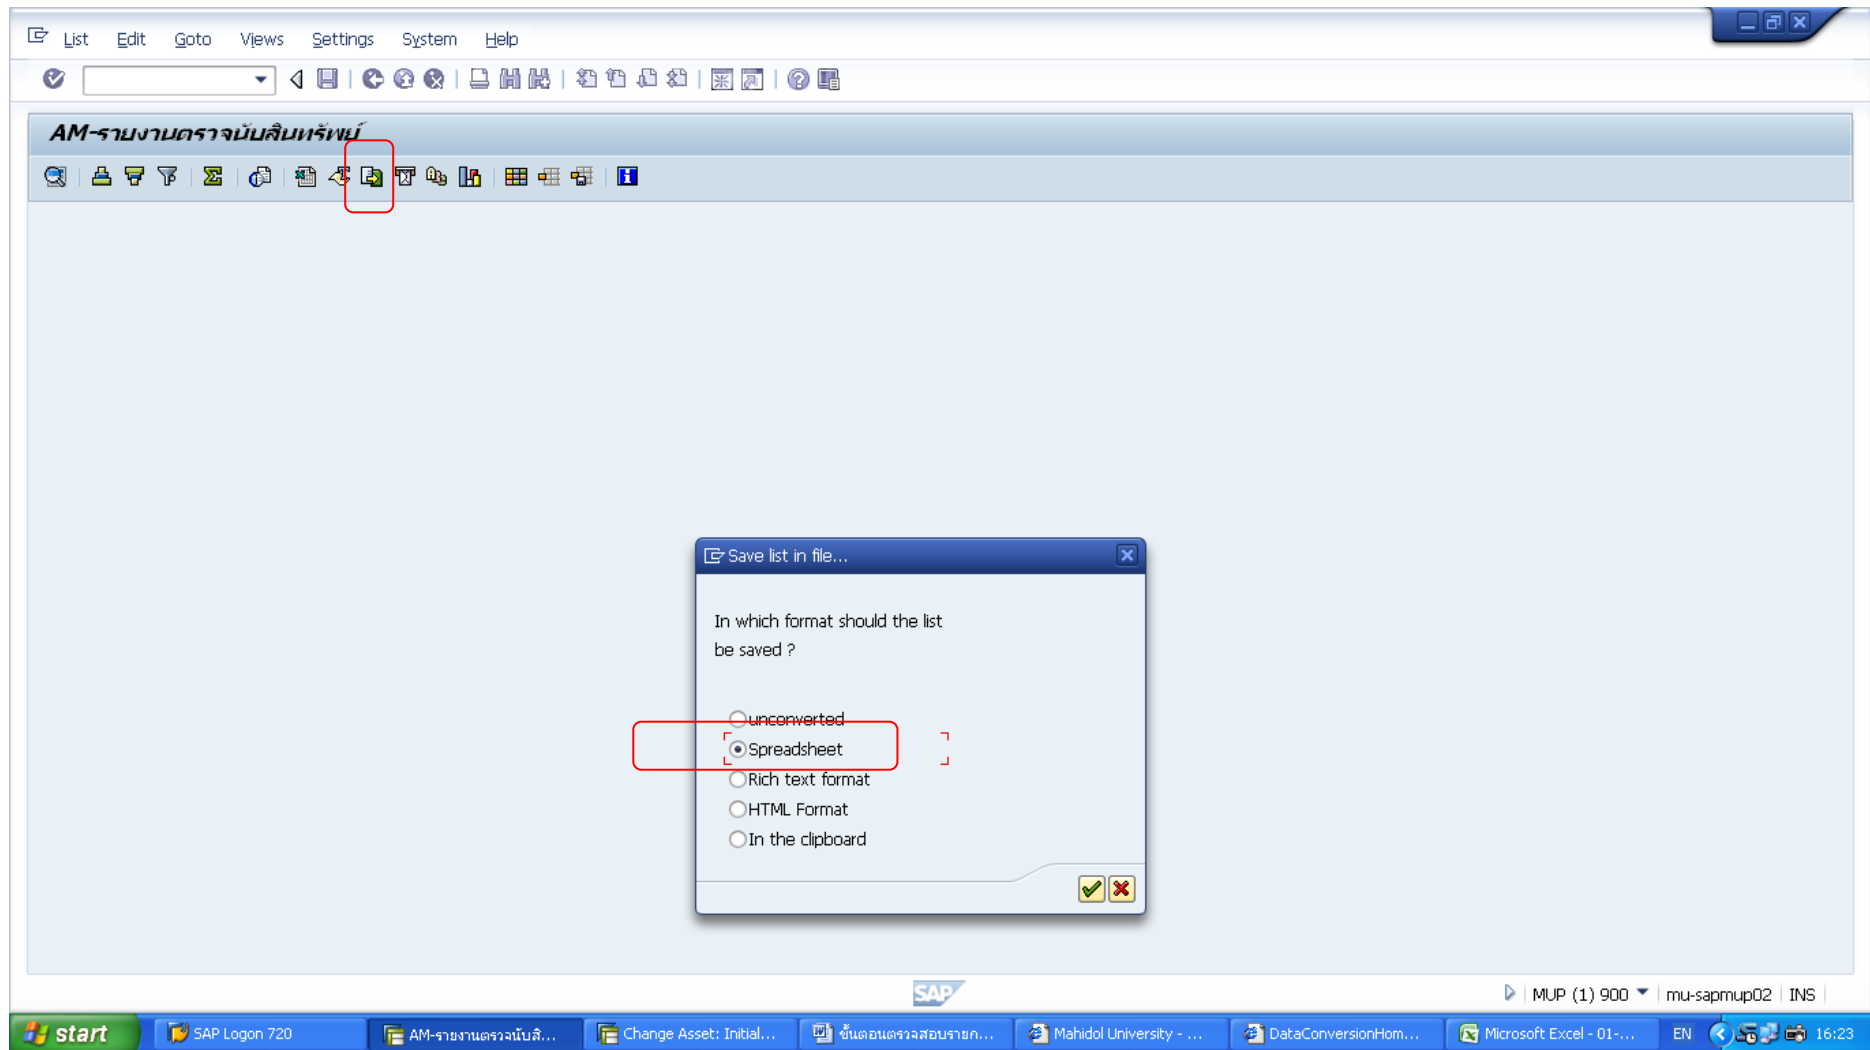


The screenshot displays the SAP user interface for a report titled "AM-รายงานตรวจนับสินทรัพย์". The main window has a menu bar with "List", "Edit", "Goto", "Views", "Settings", "System", and "Help". Below the menu is a toolbar with various icons. A red box highlights the "Local File" icon (a document with a green arrow) in the toolbar. A dialog box titled "Save list in file..." is open in the center of the screen. The dialog asks, "In which format should the list be saved?" and provides five radio button options: "unconverted", "Spreadsheet", "Rich text format", "HTML Format", and "In the clipboard". The "Spreadsheet" option is selected and highlighted with a red box. At the bottom right of the dialog are "OK" and "Cancel" buttons. The SAP logo is visible at the bottom center of the main window. The taskbar at the bottom shows the Windows Start button and several open applications, including "SAP Logon 720", "AM-รายงานตรวจนับสิน...", "Change Asset: Initial...", "ขั้นตอนตรวจสอบจาก...", "Mahidol University - ...", "DataConversionHom...", and "Microsoft Excel - 01-...". The system tray on the right shows "MUP (1) 900", "mu-sapmup02", "INS", and the time "16:23".

หน้าจอการ SAVE ข้อมูลรายงานในรูปแบบ Excel File

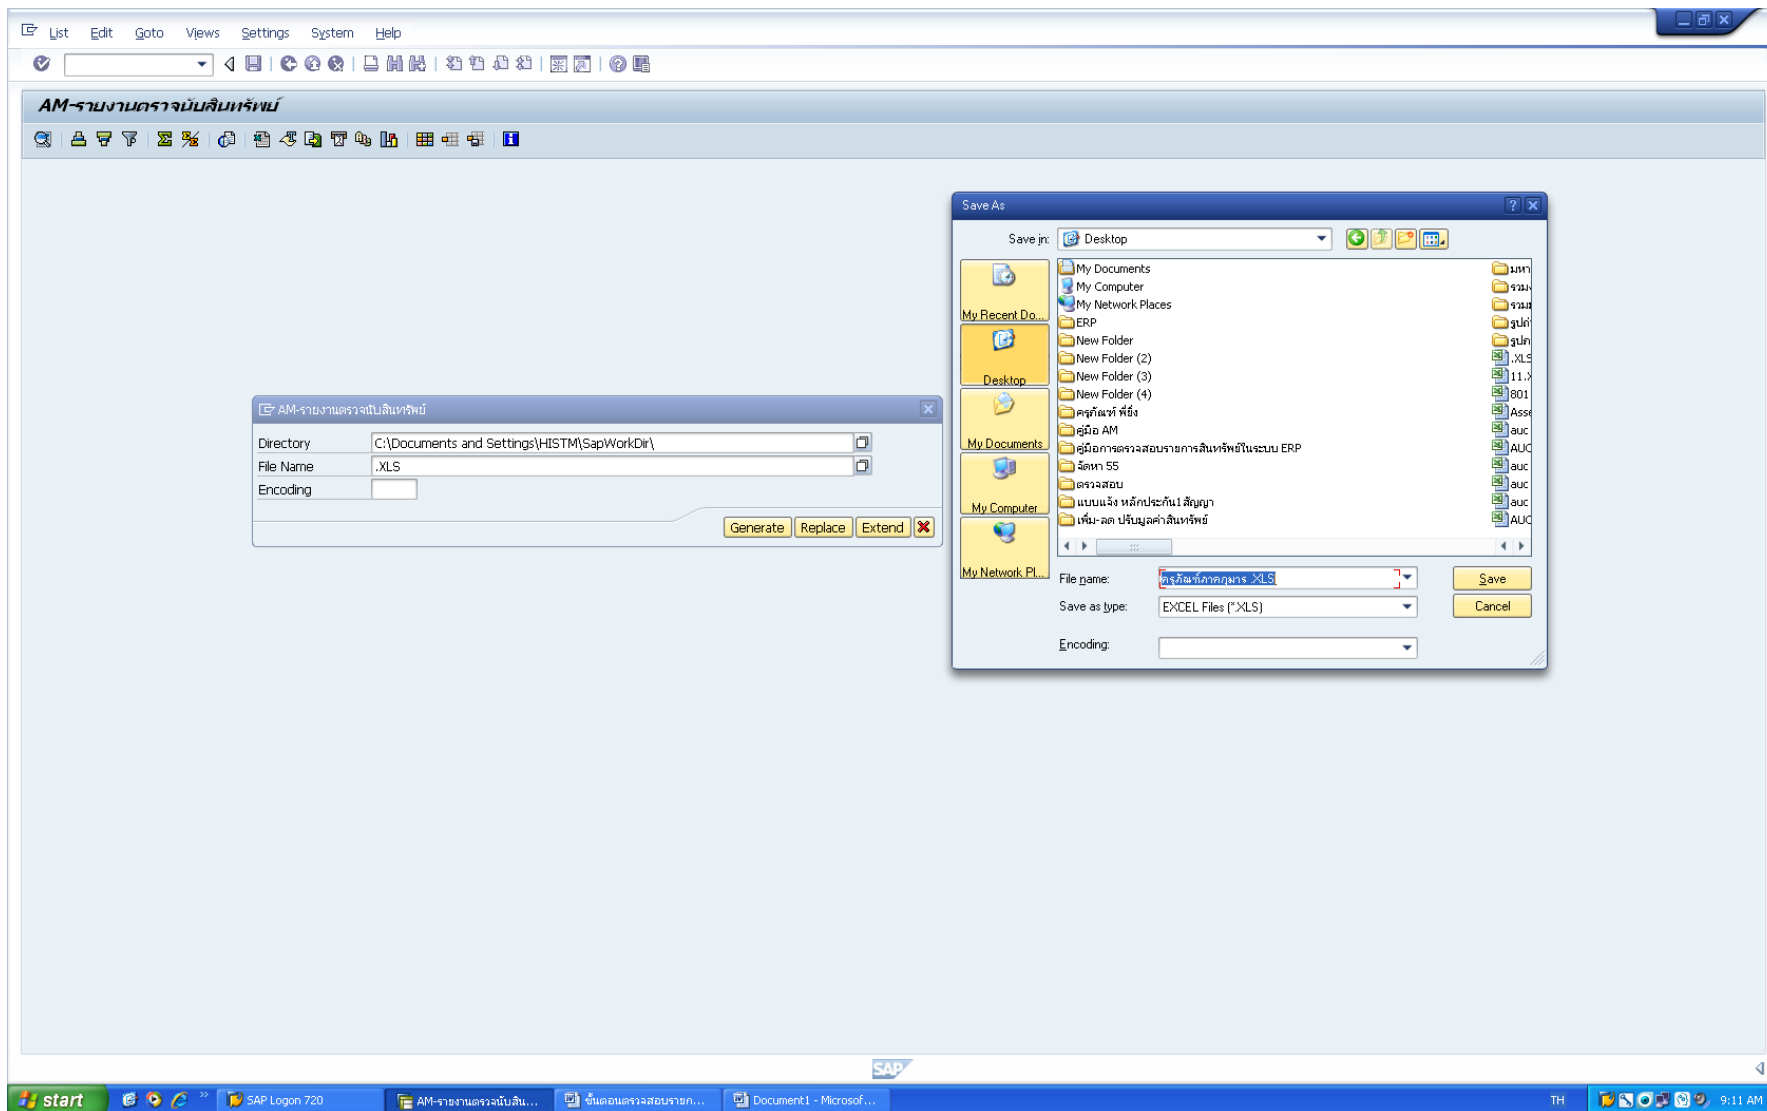


เมื่อทำการเลือก Drive และตั้งชื่อ File ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Generate เพื่อยืนยันการเก็บข้อมูล

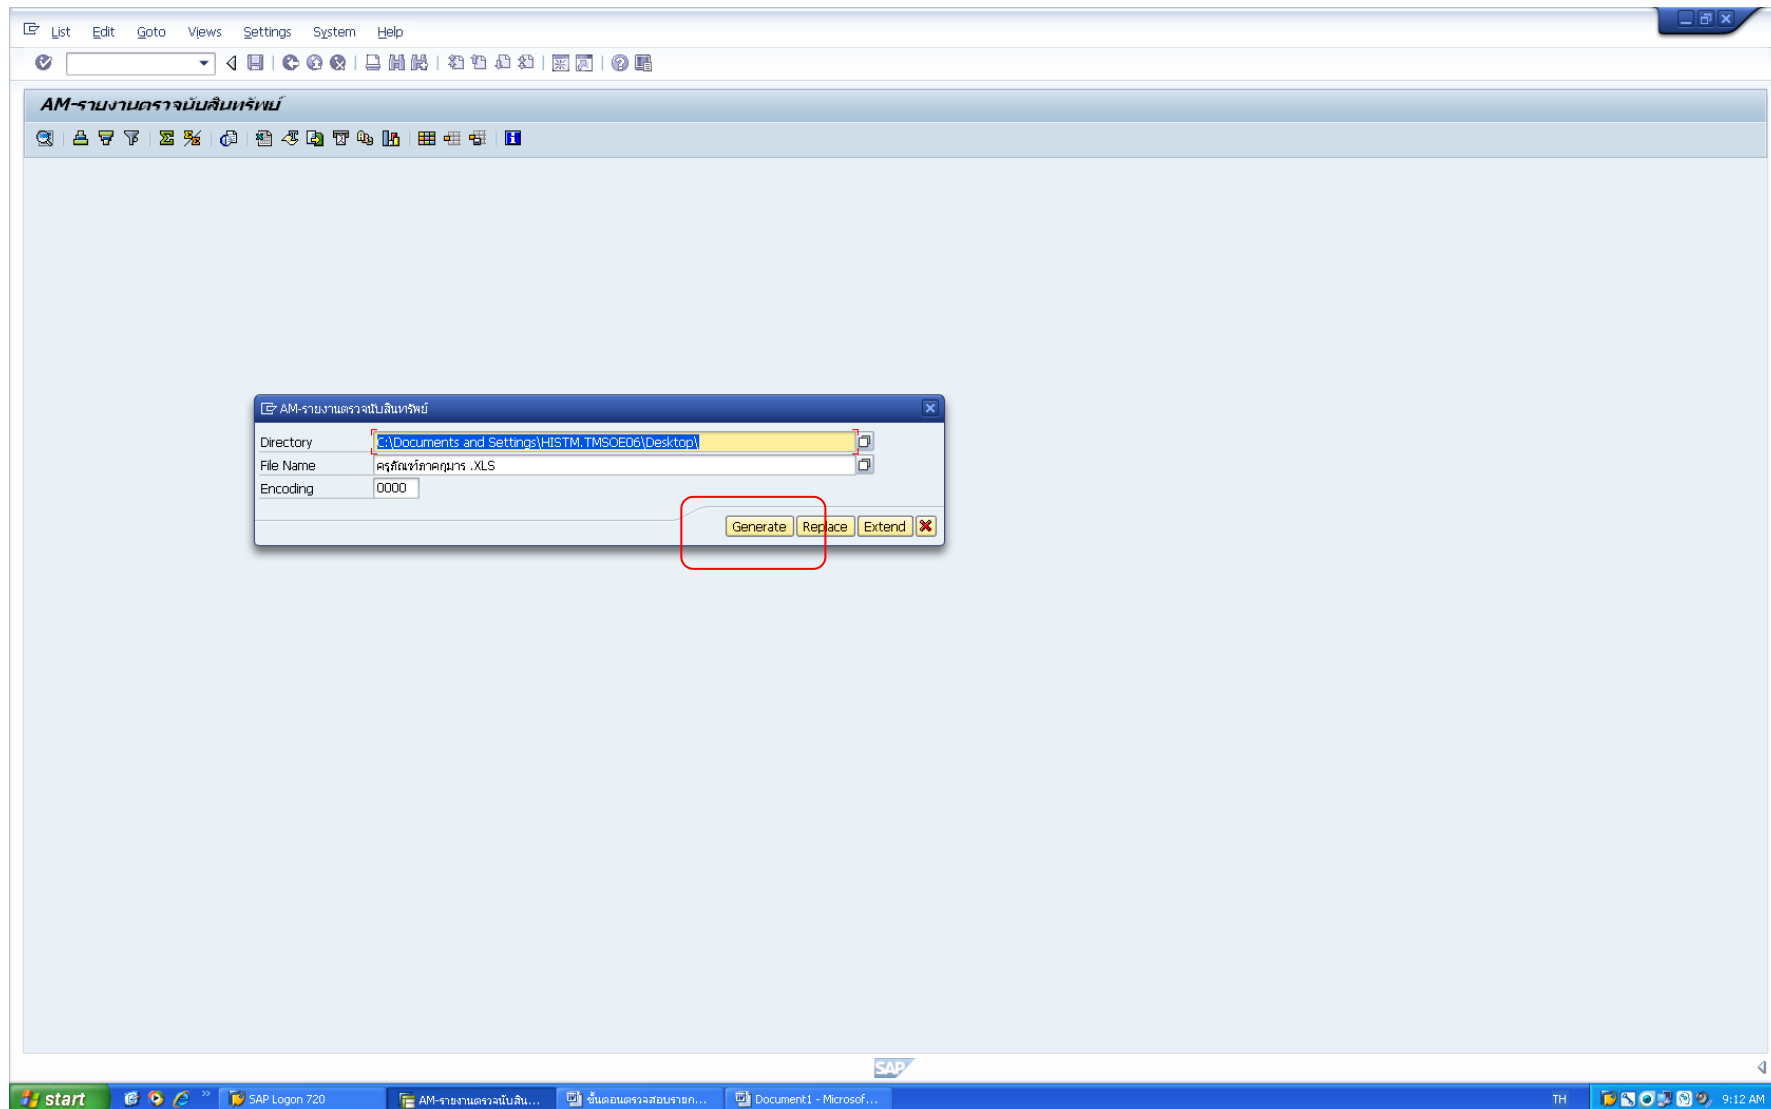


วิธีการเรียกดู “ข้อมูลหลักสิทธิ์รายตัว”

1. เรียกดูข้อมูลด้วยคำสั่ง T-code : AS03

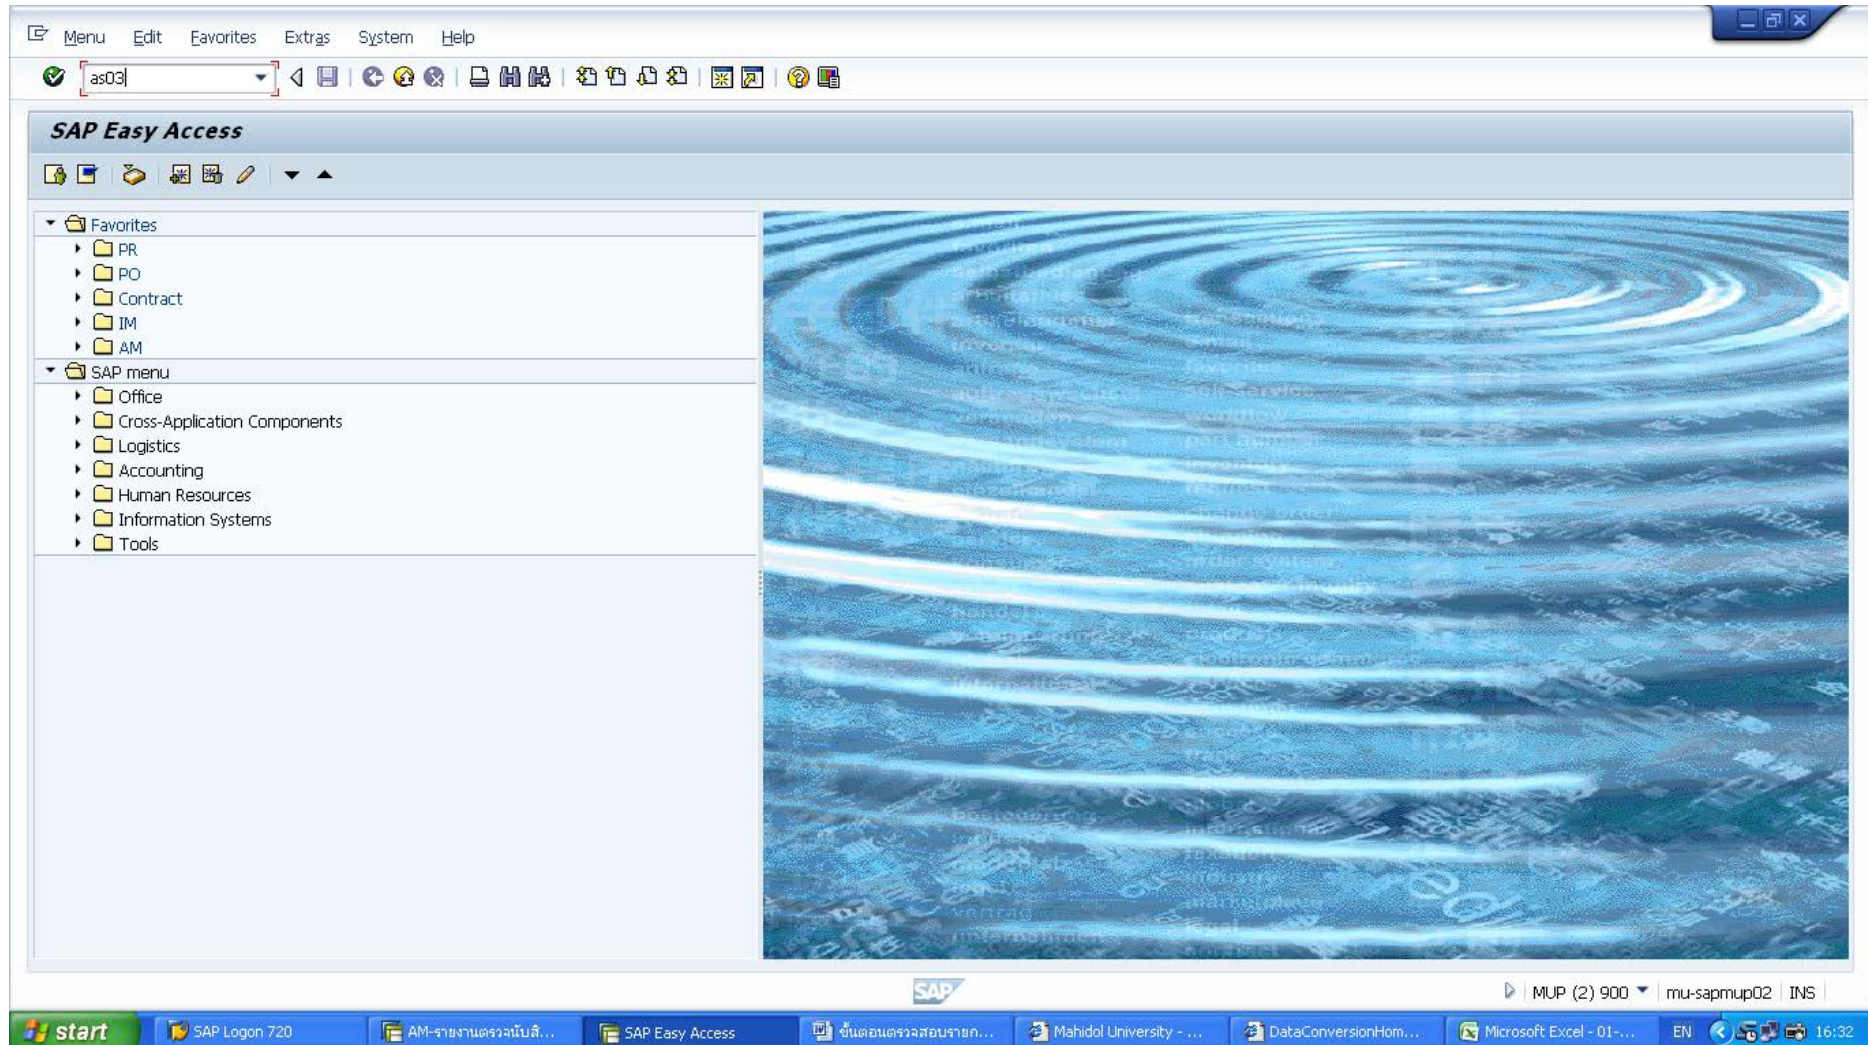

2. ระบุรหัสสินทรัพย์ 12 หลัก ที่ต้องการเรียกดู ใน Field : Asset แล้วกด Enter

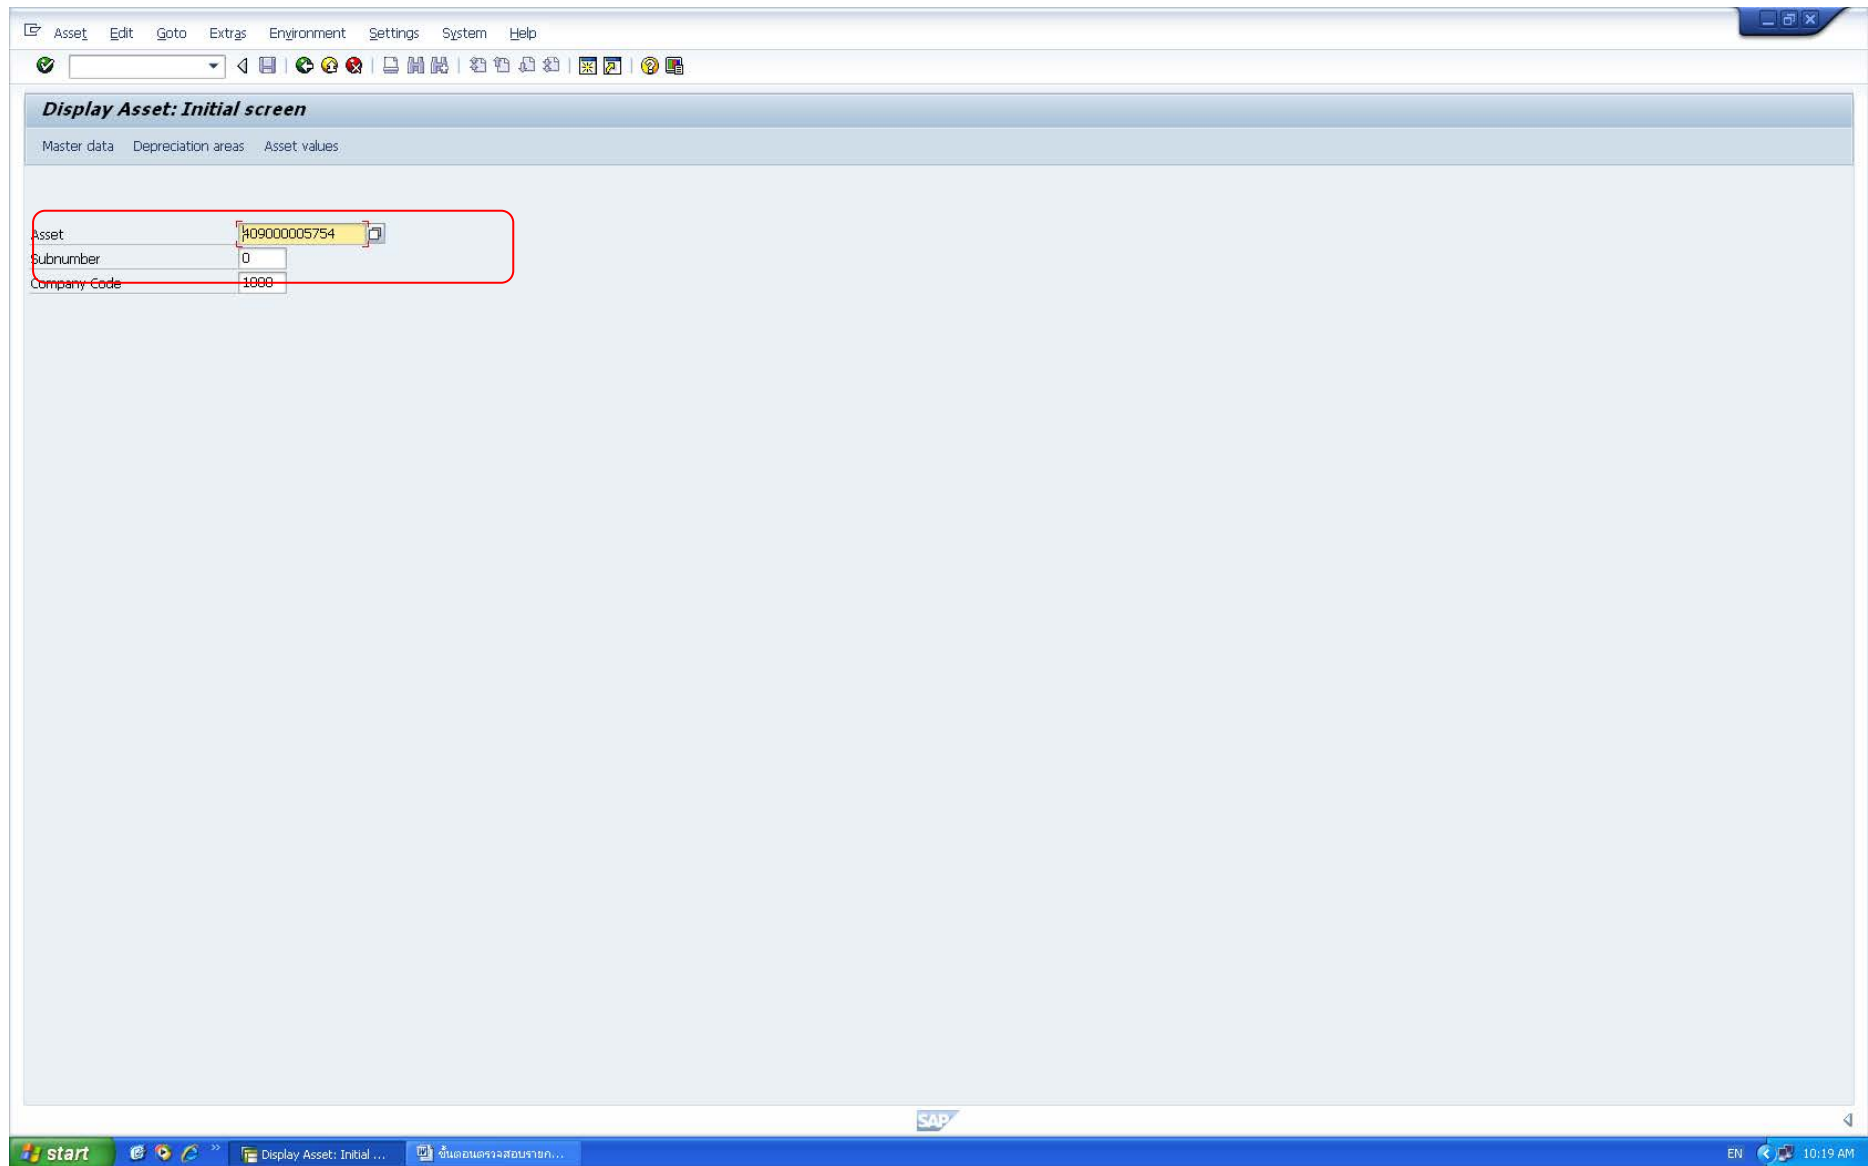

The screenshot shows the SAP Asset Management 'Display Asset: Initial screen'. The interface includes a menu bar (Asset, Edit, Goto, Extras, Environment, Settings, System, Help) and a toolbar with various icons. Below the title bar, there are tabs for 'Master data', 'Depreciation areas', and 'Asset values'. The main area contains a form with the following fields:

Asset	H09000005754
Subnumber	0
Company Code	1000

The 'Asset' field is highlighted with a red box, indicating the 12-digit asset number to be entered. The SAP logo is visible at the bottom center of the window, and the Windows taskbar at the bottom shows the time as 10:19 AM.

3. หน้าจอแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์รายตัว ที่ทำการเรียกดูจาก T-code : AS03 ใน TAB : General

The screenshot shows the SAP Asset Manager (AS03) interface. The main window title is "Display Asset: Master data". The asset number is 409000005754, and the class is 40900. The asset is described as "ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส" (Freezer with temperature not below -70 degrees Celsius). The acquisition date is 11.06.2007, and the acquisition year is 2007. The inventory number is TM-50-003-1/2, and the quantity is 1. The asset is included in the inventory list.

Field	Value
Asset	409000005754
Class	40900
Description	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส
Asset main no. text	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส
Acct determination	Z40900
Inventory number	TM-50-003-1/2
Quantity	1
Capitalized on	11.06.2007
First acquisition on	11.06.2007
Acquisition year	2007

4. หน้าจอแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์รายตัว ที่ทำการเรียกดูจาก T-code : AS03 ใน TAB : Time-dependent

The screenshot displays the SAP Asset Manager interface for 'Display Asset: Master data'. The 'Time-dependent' tab is active, showing the following data:

Asset: 409000005754 (Asset values)
Class: 40900
Company Code: 1000

Interval from 04.07.2013 to 31.12.9999

Cost Center	C1108000	TM:0 ภาควิชาทหาร
Project order		
Plant	2110	พล-คณะวิทยาศาสตร์ศรีนคริน
Location		
Room		
Personnel Number	0	
Fund	20101002	เงินบาทอุดหนุนทั่วไป
Functional Area	9900000	ไม่ระบุผลผลิต
Funds Center	1108	ภาควิชาคุณนรเวชชา

Asset shutdown:

More Intervals